

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi  
III.Uluslararası Ölçüm Bilim Kongresi 7-8 Ekim 1999 Eskişehir-Türkiye

## **REFERANS HALKA-TAMPON MASTAR (SETTING RING-PLUG GAUGES) KALIBRASYONU ve EUROMET 384 NOLU PROJE KARŞILAŞTIRMALARI, ÖLÇÜM SONUÇLARI**

*Tanfer Yandayan<sup>1</sup>, İlker Meral<sup>2</sup>, Okhan Ganioglu<sup>3</sup>*

TÜBİTAK-ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ (UME)

PK.21 41470 Gebze/KOCAELİ

Tel: 262 646 63 55

<sup>1</sup>E-Mail: tanfer@ume.tubitak.gov.tr

<sup>2</sup>E-Mail: meral@ume.tubitak.gov.tr

<sup>3</sup>E-Mail: okang@ume.tubitak.gov.tr

### **ÖZET**

Referans halka ve tampon mastarlar, ölçme cihazlarının (Örneğin Universal Ölçüm Cihazı) set-up işleminde kullanılan, cihaza izleniblilik sağlayan uzunluk standartlarıdır. Referans olarak ölçüm cihazları vasıtasyyla, diğer ürün veya standartların boyutlarının bulunmasında kullanılırlar. Referans halka ve tampon mastarlar, uzunluk biriminin dağıtımını sağlayan önemli uzunluk standartları olduğundan dolayı, doğru bir şekilde kalibre edilmelidir. Bu tip standartların kalibrasyonunda, belirsizlik hesaplarında izlenecek yolların tespit edilmesi ve ulusal metroloji enstitülerinin bu konudaki yeteneklerinin bulunabilmesi için, 1996 yılının Ağustos ayı içinde EUROMET 384 projesi adı altında Euromet üyesi 13 Avrupa ülkesi arasında karşılaştırmalı ölçümlere gidilmiştir. Proje 1998 yılında tamamlanmış ve alınan sonuçlar, 1999 sonbaharında BIPM tarafından koordine edilen, Ulusal metroloji enstitülerinin denkliğini göstermek amacıyla "karşılıklı tanıma anlaşması"nın bir hükmü olarak rapor edilecektir. UME bu ölçümlere katılarak başarılı sonuçlar elde etmiş ve diğer ulusal metroloji enstitüleri arasındaki yerini bilimsel olarak kanıtlamıştır. Bildiride referans halka ve tampon mastarların EAL normlarına göre kalibrasyon yöntemi, belirsizlik hesapları ve katılan ülkelerin karşılaştırma sonuçları sunulacaktır.

**Anahtar Sözcükler:** Çap ölçümleri, halka-tampon mastar, uluslararası karşılaştırmalar.

### **1. GİRİŞ**

Parça boyutlarını, geometrik şekillerini ve bazen de parça yüzey kalitesini kontrol etmekte kullanılan, boyutları standart ölçülerde sabitleştirilmiş kontrol aletlerine genel olarak *mastar* denir. Bir mastar normal olarak sınır ölçülerini oluşturan ölçü ve şekilleri temsil eder.

Boyutsal ölçümlerde en yüksek seviye standart olarak kullanılan mastar blokları (Gauge Block) haricindeki mastarları, özelliklerine göre ve uygulama alanlarına göre çok çeşitli sınıflara ayırmak mümkündür. Temel olarak iki grupta toplanabilir [1].

**I) Referans Mastarlar (Setting Ring and Plug Gauges):** Bu mastarlar, standartlara göre hazırlanmış en hassas mastarlardır. İsimlerinden anlaşıldığı gibi bazı cihazların (Örneğin Universal Ölçüm Cihazı) set-up işleminde kullanılarak uzunluk biriminin dağıtımını sağlayan mastarlardır. Geçer/Geçmez kısmı yoktur ve hiçbir zaman ürün ya da herhangi bir standardın, kontrolünde el ile alışırtma yöntemleri ile kullanılmaz. Sadece referans olarak, ölçüm

cihazları aracılığıyla diğer ürün ya da referans standartların boyutlarının bulunmasında kullanılır. Nominal çapın standart bir ölçüde olmasına gerek yoktur. Sadece düşük bir belirsizlik ile gerçek değerin bilinmesi yeterlidir. Önemli olan çevre boyunca ideal yuvarlaklıktaki sapma değerinin, yani yuvarlaklık (roundness) değerinin küçük olması gereklidir. Bu mastarlar için tipik yuvarlaklık değerleri  $0.06 - 0.3 \mu\text{m}$  arasında değişir ve sadece halka ve tampon mastar olarak bulunurlar.

**II) Atölye Mastarları:** Bu mastarlar, endüstride üretilen parçaların kontrolü sırasında elle alışırtma yöntemi ile kullanılan mastarlardır. Atölye mastarlarının ürün yelpazesi genişİR ama temel olarak üç grupta toplanırlar;

- a) İç çap mastarları (Tampon mastarlar)
- b) Dış çap mastarları
  - 1) Halka mastarlar
  - 2) Çatal (Ay) mastarlar (Sabit ve Ayarlı çatal mastarlar)
- c) Özel mastarlar
  - 1) Profil mastarları
  - 2) Radyus mastarları
  - 3) Kare tampon mastarları
  - 4) Derinlik mastarları

Bu bildirinin amacı referans mastarların kalibrasyon yöntemlerini açıklayarak, EUROMET 384 nolu proje kapsamında gerçekleştirilen karşılaştırma sonuçlarını aktarmaktır.


## 2. EAL-G29'A GÖRE HALKA-TAMPON MASTAR KALİBRASYON YÖNTEMİ

*Referans Halka ve Tampon Mastar Kalibrasyonu:* Hassas ölçme cihazlarının set-up işleminde kullanılan bu mastarların esas görevi, ölçümü yapılacak herhangi bir ürünün veya mastarın boyutunun bulunmasında standart olarak kullanılmaktır. Bazen hassas ölçüm cihazlarının (Örneğin CMM'lerin) açılış verifikasyonlarının yapılmasında da kullanılırlar. Bu yüzden üzerindeki işaretli yerlerden çap boyutunun düşük bir belirsizlikle bilinmesi gereklidir. Bu boyutun düşük bir belirsizlikle bilinebilmesi için referans mastarların iyi bir forma sahip olmaları gereklidir. Bu yüzden bu tip mastarların kalibrasyonunda form ölçümleri yapılmalı ve değerleri hesaba katılmalıdır.

UME Boyutsal Laboratuvarı'nda yapılan çap ölçümleri, Mahr 828 CIM Universal Ölçme cihazı kullanılarak, halka mastar kalibrasyonunda referans halka mastarlar ( $\varnothing 40 \text{ mm}$  ve  $\varnothing 3 \text{ mm}$ ), tampon mastar kalibrasyonunda referans Johnson mastar blokları kullanılarak yapılmaktadır. İç çap ölçümlerinde  $200 \text{ mN}$  ile  $400 \text{ mN}$ , dış çap ölçümlerinde ise  $1 \text{ N}$  ile  $2 \text{ N}$ 'luk kuvvetler uygulanmaktadır. Ölçüm sonuçları,  $0 \text{ N}$ 'luk kuvvette çevrilerek verilmektedir..

### 2.1. Tampon Mastarlarda Çap Ölçümleri

Mastarın ölçümünden önce, cihaz üzerinde gerekli ayarlamalar yapılır. Cihaz, ölçülecek mastarın nominal çap ölçüsüne yakın ölçüye sahip bir mastar bloğu ya da referans tampon mastarı kullanılarak set edilir. Tampon mastar, işaretli yüzeyi üsté kalacak şekilde cihazın ölçüm tablosu üzerine yatık sabitlenir (Şekil 1). Sabitleme işlemi tampon mastarlarda V-yatakları kullanarak, pimlerde ise "pin vise"lar kullanılarak yapılmaktadır. Sabitleme konumuna göre maksimum ve minimum noktalar bulunarak ölçüm yapılır.

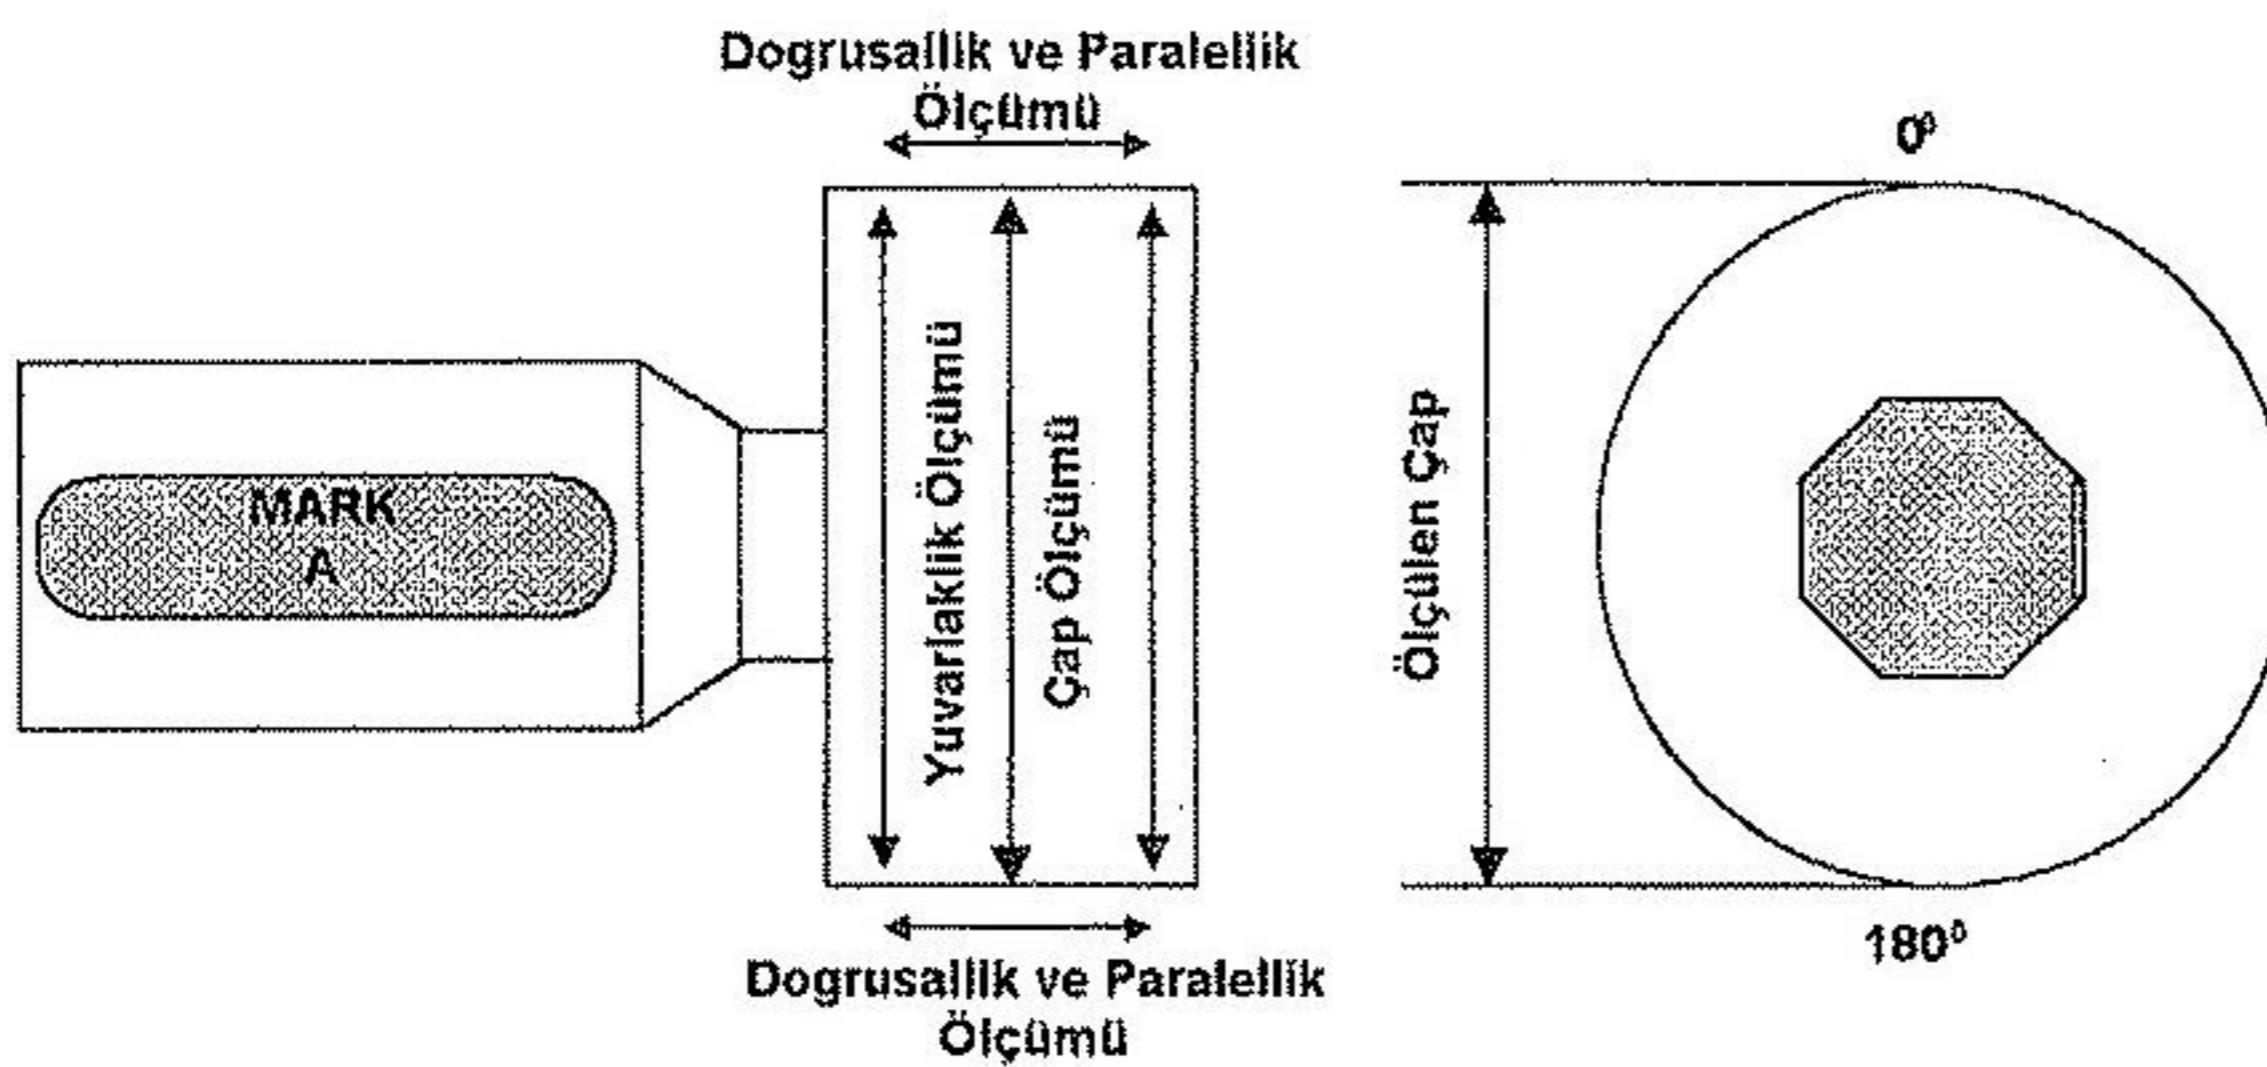

Sekil 1. Çap ölçümü ve form ölçümelerinin (yuvarlaklık, doğrusallık ve paralellik) yapıldığı noktalar.


## 2.2. Halka Mastarlarda Çap Ölçümleri

Mastarın ölçümünden önce, cihaz üzerinde gerekli hazırlıklar yapılır ve referans standart halka mastar kullanılarak set edilir. Halka mastar, işaretli yüzeyi üstte kalacak ve yazıları operatöre bakacak şekilde cihazın ölçüm tablosu üzerine yatık olarak sabitlenir. Sabitleme konumuna göre maksimum ve minimum noktaları bulunur ve ölçüm halka mastarın kenar yüksekliğinin orta noktasından yapılır.

## 2.3. Mastarların Form Ölçümü

Mastarların kalitelerini anlamak ve boyut ölçülerinin ne kadar kesin olduğunu saptamak için gereklidir. Elde edilen form ölçüm sonuçları, boyut ölçümünün belirsizlik hesaplamalarında kullanılır. Form ölçümleri, form ölçüm cihazı kullanılarak gerçekleştirilir. Yuvarlaklık ölçümleri, tabla üzerine yerleştirilen mastarların gerekli ayarları yapıldıktan sonra, mastarın kenar yüksekliğinin orta noktası, orta noktanın üstü ve altından mastar boyutuna göre seçilen üç noktadan yapılır (Genelde 5 mm). Paralellik ve doğrusallık ölçümleri, yuvarlaklık ölçümlerinin yapıldığı yüksekliklerin arasında,  $0^{\circ}$ - $180^{\circ}$  ölçüm kenarlarında gerçekleştirilir.

Eğer form ölçümü çeşitli nedenlerden dolayı yapılamıyorsa (form ölçme cihazı yoksa), test edilen mastarın formu hakkında bilgi edinilemediğinden, yapılan çap ölçümünün doğruluğundan emin olmak için farklı bir ölçüm yöntemi kullanılır. Böylece form bozukluğundan gelen hata ölçüm belirsizliğine eklenir. Tablaya yerleştirilen referans mastarın ölçülecek çap kısmının orta noktasından ölçüm alınır. Mastar ölçüm eksenine göre  $10^{\circ}$  sağa ve  $10^{\circ}$  sola tabla üzerinde çevrilerek (Şekil 2, 1. ve 2. noktalar) iki ölçüm daha alınır. Orta noktanın 1 mm altından ve üstünden de (Şekil 2, 3. ve 4. noktalar) ölçüm alınarak toplam beş ölçüm yapılır [2].

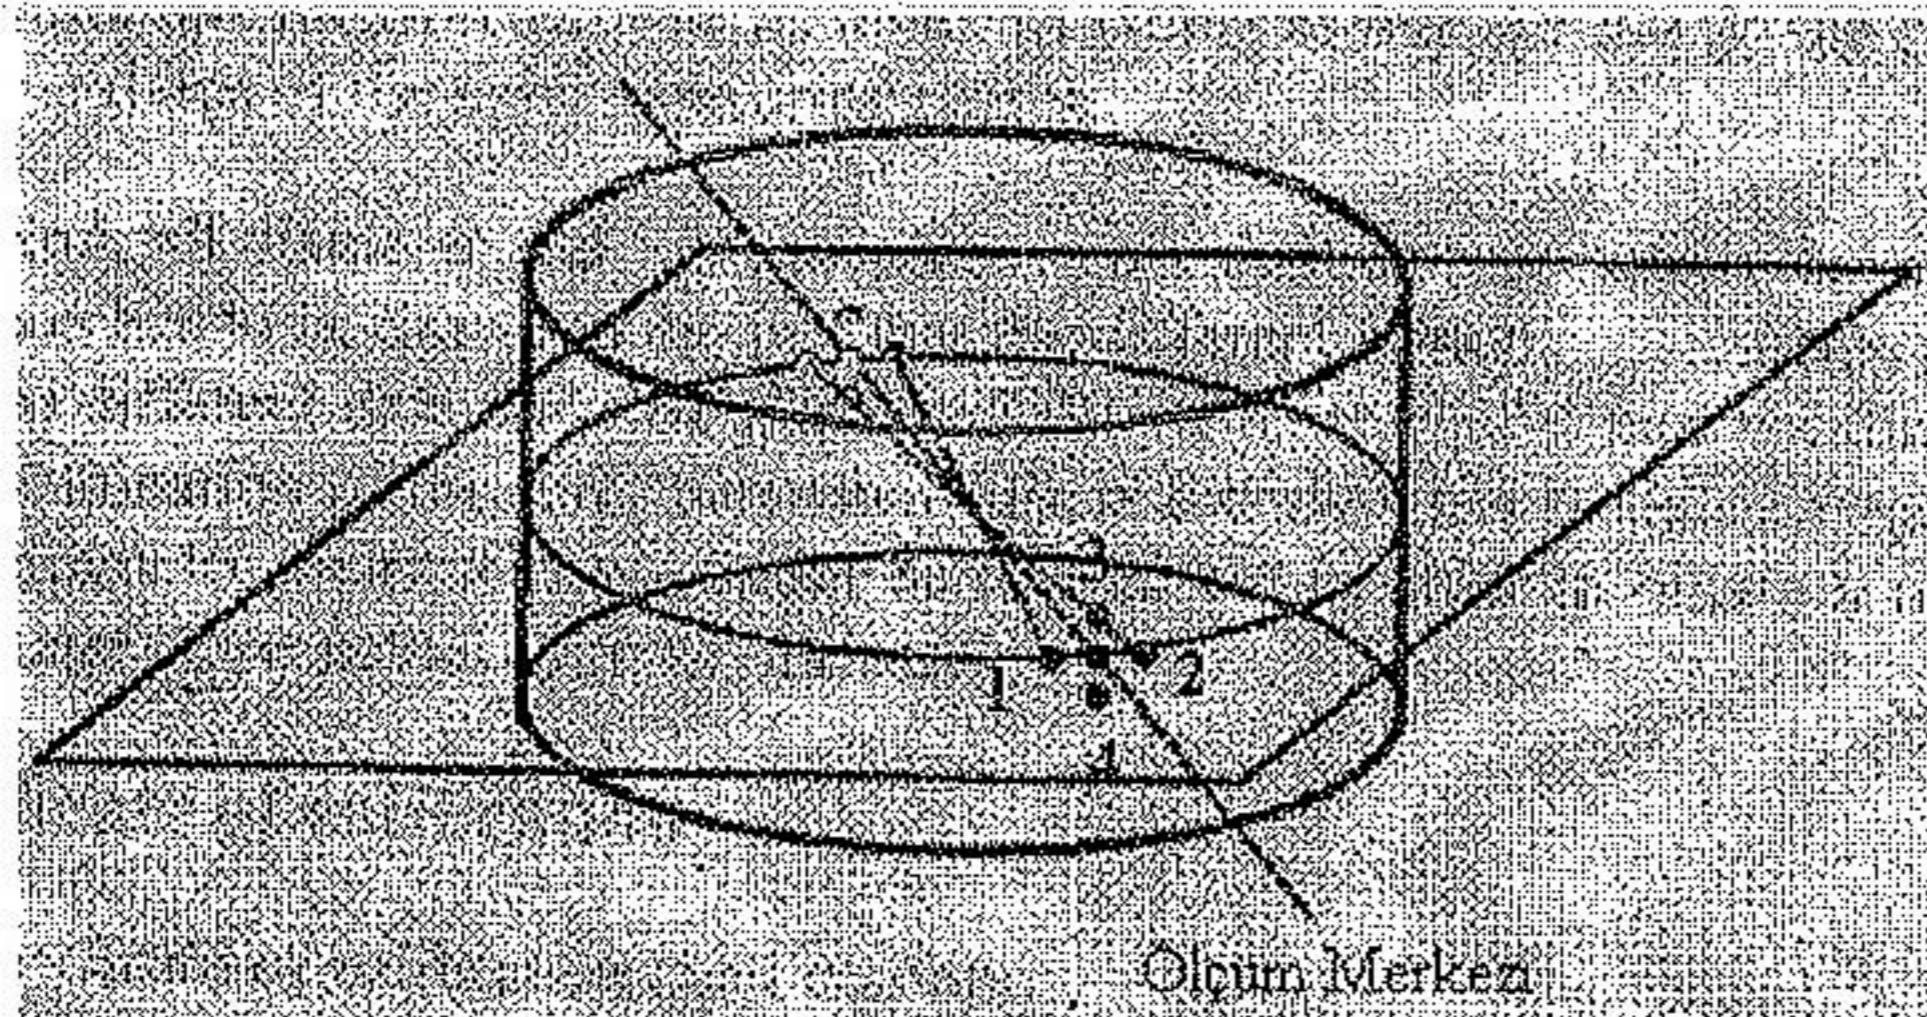

Sekil 2. Ölçülen beş noktanın profili. 1. ve 2. nokta  $10^{\circ}$ 'lık sapma ile sağdan ve solda alınan ölçümler. 3. ve 4. Noktalar 1mm üst ve alt alınan ölçümler

### 3. EUROMET 384 NOLU PROJE

Silindiriksel çap standartlarının kalibrasyonu için en önemli karşılaştırma 1996 ve 1998 yılları arasında yapılmıştır. OFMET pilot laboratuvar olarak, toplam 12 Avrupa Ulusal Metroloji Enstitüsü (Tablo 1) bu projeye katılmıştır. Ekim 1995'te EUROMET kontak kişileri silindirilik standartlarının kalibrasyonu için laboratuvarlar arası karşılaştırmayanın (EUROMET proje no 384) yapılmasına karar vermişlerdir. Karşılaştırma, nominal çapları 2.5 mm ve 90 mm arasında olan üç halka ve iki tampon mastarların laboratuvarlara sırayla gönderilerek Ağustos 1996'da başlamıştır. Karşılaştırma, pilot laboratuvarın ölçüümüyle başlamış ve pilot laboratuvarın ölçüümüyle son bulmuştur. Herhangi bir sonuç katılımcıya gönderilmeden önce, bu karşılaştırma "regional key comparison" (Bölgesel metroloji kurumlarının aralarında yaptığı ve daha sonra CIPM karşılaştırmaları olarak yapılacak karşılaştırmalar), EUROMET.L-K4, olarak ilan edilmesine karar verilmiştir [3].

Tablo 1. Karşılaştırmaya katılan ülke ve metroloji enstitüleri

Kod	Ülke	Laboratuvar, yer ve kontak kişiler
CMI	ÇEK CUMHURİYETİ	Czech Metrological Institute, Prague, Petr Balling
GUM	POLONYA	Central Office of Measures, Warszawa, Zbigniew Ramotowski
IMGC	İTALYA	Istituto di Metrologia G. Colonnetti, Torino, Attilio Sacconi
LNE	FRANSA	Laboratoire National d'Essais BNM/LNE, Paris, Georges Vailleau
NMi	HOLLANDA	NMi Van Swinden Laboratorium, AR Delft, Gerard Kotte
NPL	İNGİLTERE	National Physical Laboratory, Teddington, David Flack
OFMET	İSVEÇ	Swiss Federal Office of Metrology, Wabern, Ruedi Thalmann
OMH	MACARİSTAN	Országos Mérésügyi Hivatal, Budapest Kálmán, Tomanyiczka
PTB	ALMANYA	Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Frank Lüdicke
SP	İSVİÇRE	Swedish National Testing and Research Institute, Borås, Mikael Frennberg
UME	TÜRKİYE	Ulusal Metroloji Enstitüsü, Gebze-Kocaeli, Tanfer Yandayan
VTT	FİNLANDIYA	VTT Manufacturing Technology, Espoo, Heikki Lehto

#### 3.1. Ölçümü Yapılan Standartlar

Beş silindiriksel standart ölçülmüştür (Tablo 2). Kullanılan standartların kalitesini anlamak ve ölçülen standartların belirsizliğinin hesaplanması için form ölçümleri pilot laboratuvar (OFMET) tarafından yapılmıştır. Belirtilen üç ölçme yüksekliğinde yuvarlaklık profili, ölçüm yönünde oluşturulan hat üzerinde doğrusallık profili ve iki doğrusallık profiline paralellik ölçümü. Kullanılan standartların nominal boyutları ve form değerleri Tablo 2'de verilmiştir. [3]


Tablo 2. Ölçümü yapılan referans mastarlar

TİP	Üretici ve Seri No	Boyuşlar Malzeme	Yuvarlaklık	Doğrusallık	Paralellik
HALKA (RING)	Microvol EAM00796	Ø 90 mm h. 32.1 mm Çelik	5 mm ↑ 0.08 µm Orta 0.08 µm 5 mm ↓ 0.10 µm	0° 0.13 µm 180° 0.07 µm	180°/0° 0.16 µm
HALKA (RING)	SIP N° 41182	Ø 90 mm h 32 mm Çelik	5 mm ↑ 0.07 µm Orta 0.08 µm 5 mm ↓ 0.06 µm	0° 0.08 µm 180° 0.07 µm	180°/0° 0.10 µm
HALKA (RING)	Microvol 133	Ø 3 mm 4.7 mm Tungsten Karbid	1 µm ↑ 0.07 µm Orta 0.10 µm 1 µm ↓ 0.06 µm	0° 0.03 µm 180° 0.03 µm	180°/0° 0.08 µm
TAMPON (PLUG)	SIP N° 41727	Ø 50 mm h 25 mm Çelik	5 mm ↑ 0.16 µm Orta 0.15 µm 5 mm ↓ 0.23 µm	0° 0.09 µm 180° 0.07 µm	180°/0° 0.09 µm
TAMPON (PLUG)	Diamond 02796	Ø 2.5 mm h 17.5 mm Çelik	5 mm ↑ 0.09 µm Orta 0.10 µm 5 mm ↓ 0.07 µm	0° 0.04 µm 180° 0.04 µm	180°/0° 0.04 µm

Her standardın çap ölçümü, işaret çizgileri yönünde yuvarlaklık ölçümülerinin yapıldığı üç değişik yükseklikte yapılmıştır ve sadece orta yükseklikteki sonuçlar raporlanmıştır. Ölçüm sonuçları; 0 N'luk kuvvette göre, referans sıcaklık 20 °C'ye göre ve sıcaklıkla uzama katsayısı,  $11.6 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$  alınarak hesaplanmıştır.

### 3.2. Ölçüm Sonuçları

Standartların orta noktasında yapılan çap ölçüm sonuçları ve genişletilmiş belirsizlik ( $k=2$ ), her referans için aşağıda verilmiştir [3].

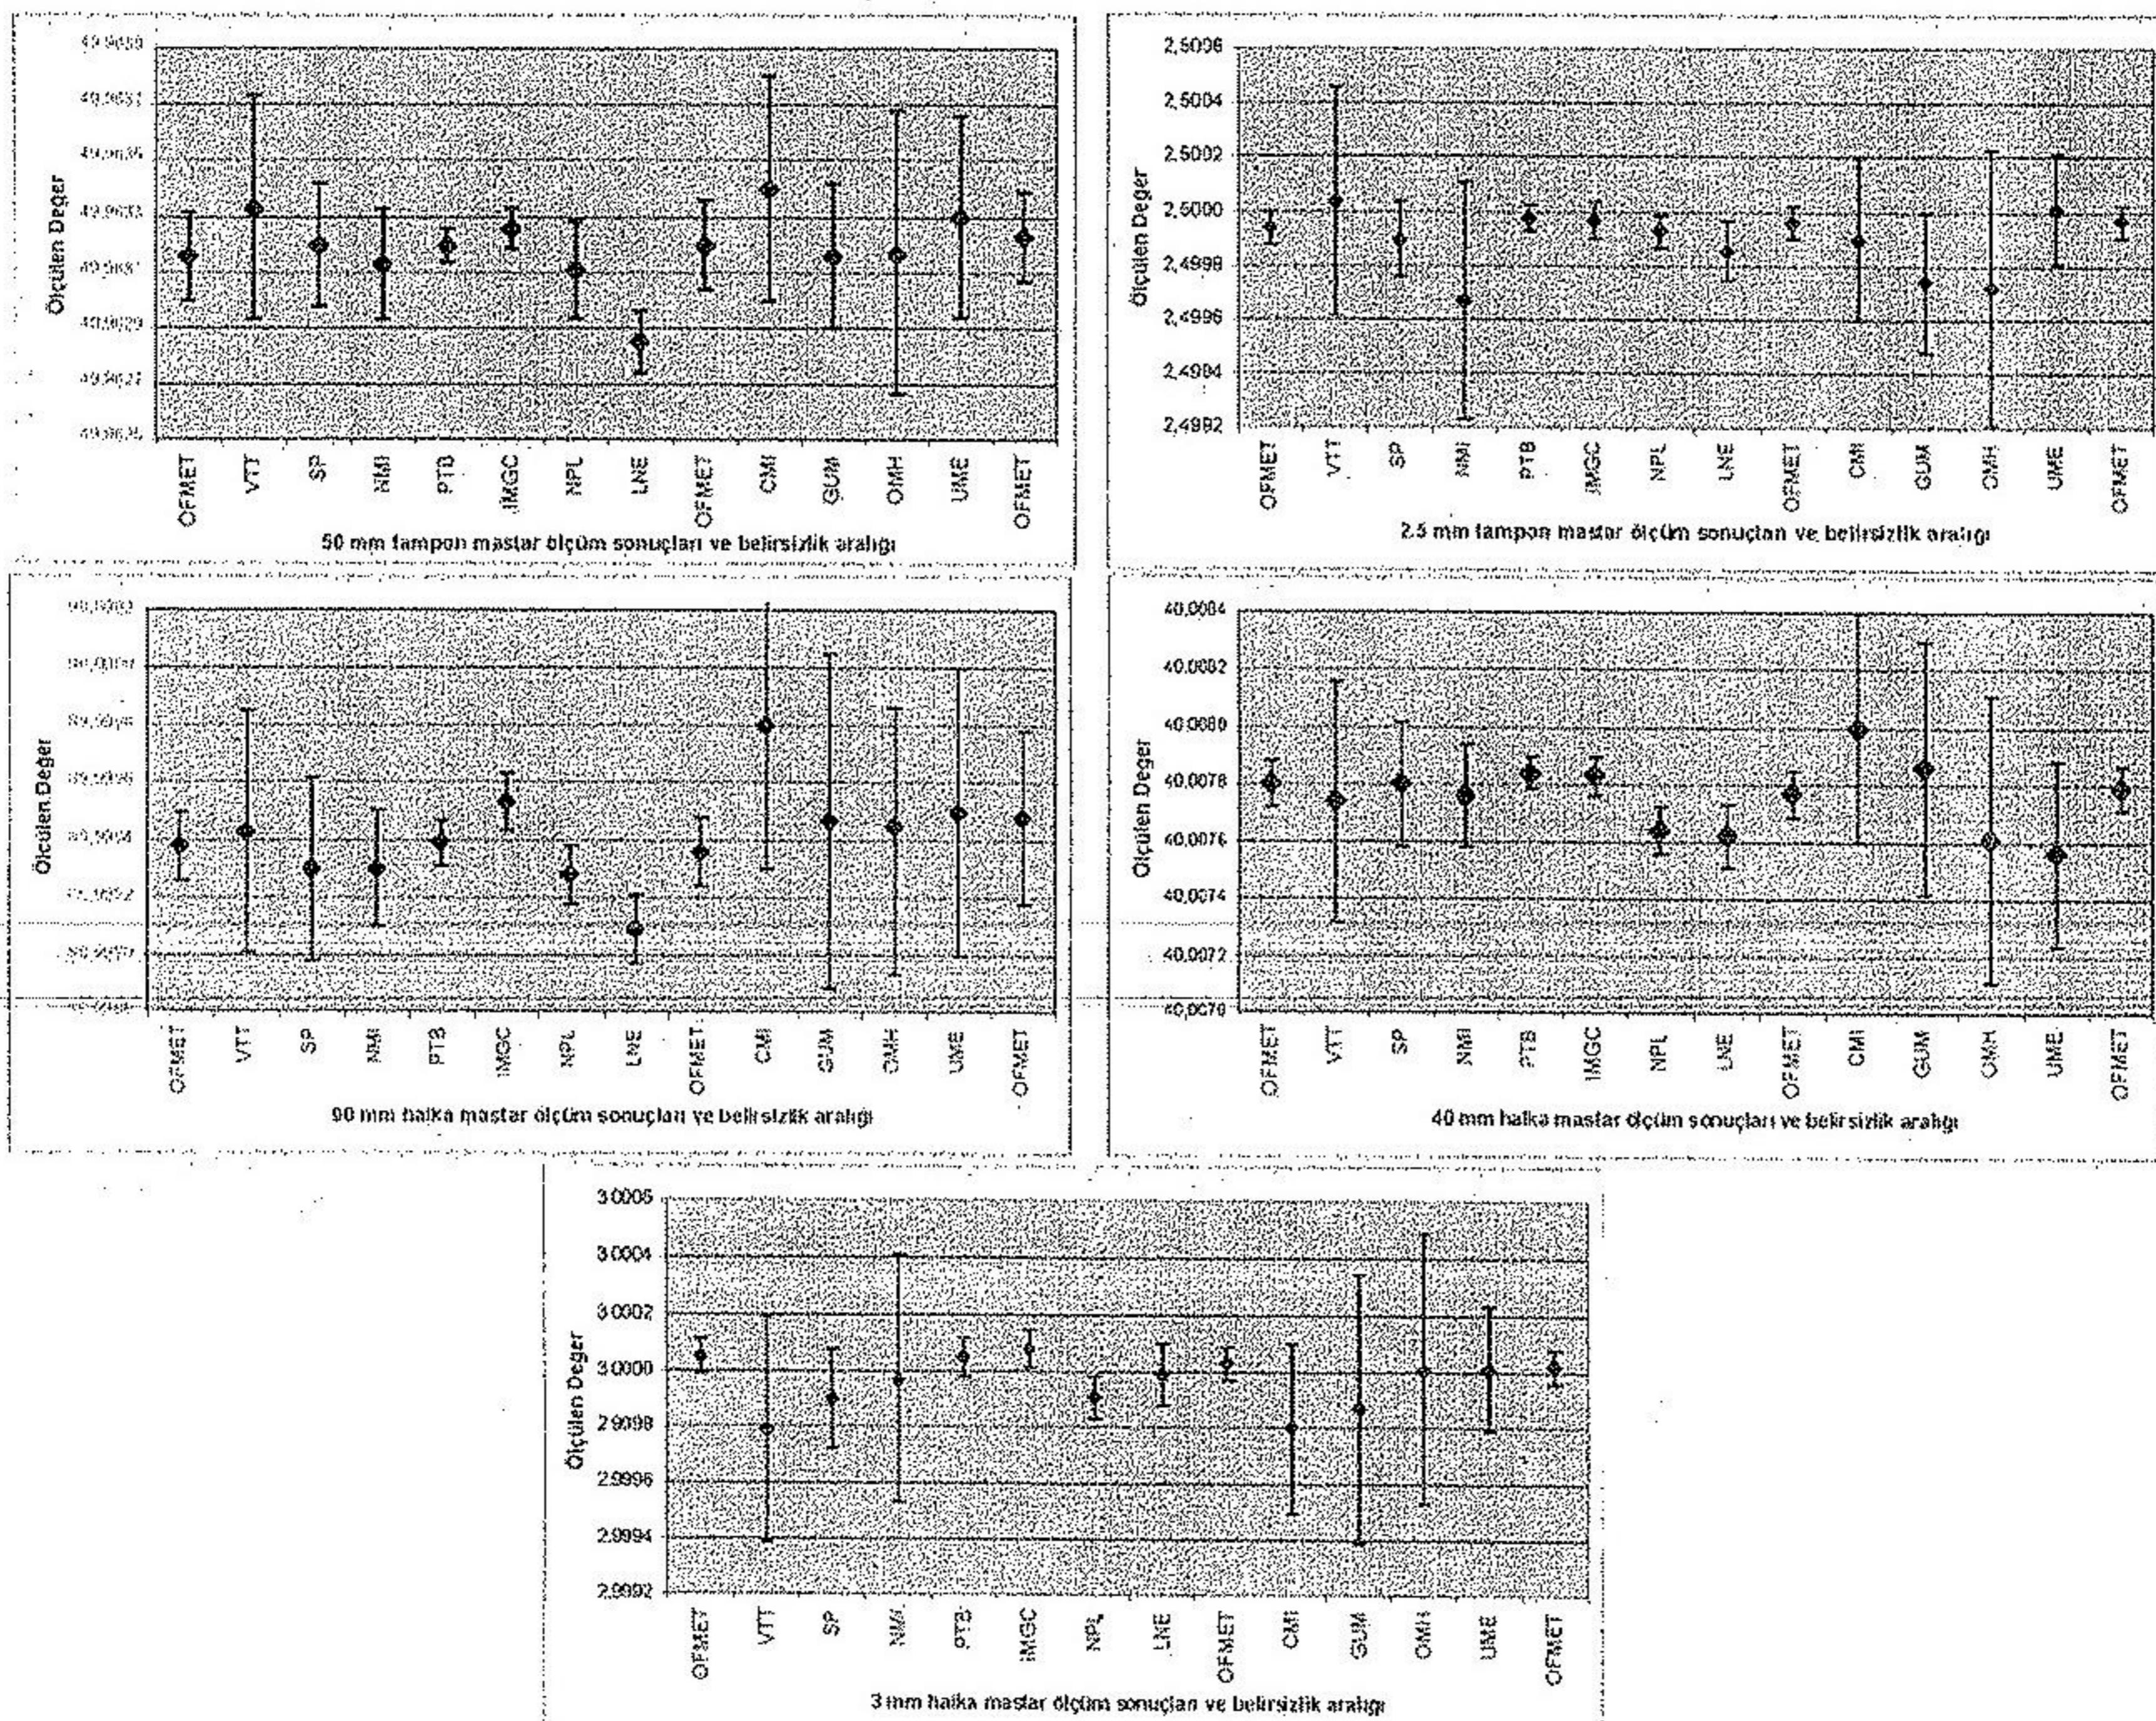

<b>OFMET (İSVİÇRE)</b>	<b>NPL (İNGİLTERE)</b>
<b>VTT (FİNLANDİYA)</b>	<b>LNE (FRANSA)</b>
<b>SP (İSVEÇ)</b>	<b>CMI (ÇEK CUMHURİYETİ)</b>
<b>NMI (HOLLANDA)</b>	<b>GUM (POLONYA)</b>
<b>PTB (ALMANYA)</b>	<b>OMH (MACARİSTAN)</b>
<b>IMGC (İTALYA)</b>	<b>UME (TÜRKİYE)</b>

#### **4. BELİRSLİLK BÜTÇESİ**

Ölçüm belirsizliğinin hesaplanması “ISO-Guide to expression of uncertainty in measurement”a göre yapılmıştır.

Belirsizlik hesaplanmasında aşağıdaki faktörler alınmıştır.

- Ölçüm tekrarlanabilirliği,
- Referans standart (Referans halka mastar ve Johnson mastar bloklar),
- Ölçme cihazının skala hatası,
- Kalibre edilen mastarın form hatası,
- Sıcaklık,
- Kosinüs hatası: Ölçme yönüne göre skalanın ayarlanması,
- Maksimum çap arama noktası hatası,
- Cihazın dijital çözünürlüğü.

#### **5. SONUÇ**

Halka ve tampon mastarların karşılaştırmaları bütün katılımcı ülkelerin denkliklerini görmeleri açısından çok faydalı olmuştur. Bu karşılaştırma, BIPM Key Comparison kuralları doğrultusunda, boyutsal metroloji alanında EUROMET dahilinde gerçekleştirilen ilk Key Comparison' dir.

EUROMET Project 384, Calibration of ring and plug gauges, adı altında karşılaştırmalı ölçümlerin sonucunda UME Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmiş ve diğer ulusal metroloji enstitüleri arasındaki yerini bilimsel olarak ispatlamıştır. UME tarafından yapılan çap ölçümlerinin güvenirliği uluslararası alanda belgelenmiş olmaktadır. Karşılaştırma sonuçları, 1999 sonbaharında BIPM tarafından koordine edilen, Ulusal metroloji enstitülerinin denkliğini göstermek amacıyla "karşılıklı tanıma anlaşması"nın bir hükmü olarak rapor edilecektir.

#### **6. KAYNAKLAR**

1. O. Ganoğlu, O. Yaman ve İ. Meral, BOY1A Eğitim Dökümanı, UME, Gebze, 1998
2. EAL-G29 Guidance Publication, Calibration of Ring and Plug Gauges, 1997
3. R. Thalman, EUROMET Project 384, Interlaboratory key comparison: Calibration of ring and plug gauges, Final Report (draft B), April 1999.